

Design and Development of TaqMan Real-Time PCR Assay for Detection and Viral Load Determination of HIV-1

Hassan Noorbazargan¹, Seyed Alireza Nadji², Siamak Mirab Samiee³, Mahdi Paryan^{4,*},
Samira Mohammadi-Yeganeh^{5,6,*}

1. Department of Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Virology Research Center (VRC), National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. Food and Drug Laboratory Research Center, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran

4. Department of Research and Development, Production and Research Complex, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

5. Cellular and Molecular Biology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6. Department of Biotechnology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

(Received: 2018/02/16

Accept: 2018/07/22)

Abstract

Background: Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) is one of the most important blood-borne infectious viruses that are considered a global problem, thus it is important to diagnose it with high accuracy and sensitivity. Serologic methods do not adequately detect this infection. Therefore, the purpose of the present study was to design a sensitive method based on TaqMan Real-time PCR method for diagnosis of HIV-1.

Materials and Methods: Primers and probes were designed using bioinformatics softwares for a region of 200 pairs of HIV-1 INT gene. The sequence was cloned into T/A cloning vector and in-vitro RNA transcription was performed to prepare standards for analytical sensitivity assay. To determine the analytical specificity, NCBI BLAST and different viral and bacterial samples were used. Clinical specificity was determined using negative plasma samples.

Results: The method introduced was able to detect as low as 10 copies of HIV-1 RNA/ml. Furthermore, it was linear in the range of 10-10⁹ copies/ml. By examining the negative samples, the specificity of this method was determined to be 100%. Intra- and Inter-assay results ranged from 0.3% to 2.5% and 0.7% to 4.5%, respectively, that showed high reproducibility of the assay.

Conclusion: Due to proper sensitivity and specificity, rapid analysis, being user-friendly, and relatively low cost, as compared with commercial kits, the method introduced in the present study can be suitable to accurately diagnose HIV-1 virus. Applying this in-house Real-time PCR assay, viral infection can also be detected before seroconversion and appearance of bloodstream antibodies, which can reduce window period of this infection.

Keywords: HIV-1; TaqMan Real-time PCR; INT gene; Quantification; Viral load

* Corresponding Author: Samira Mohammadi-Yeganeh
Email: s.mohammadiyeganeh@sbmu.ac.ir

طراحی و راه اندازی روش TaqMan Real-time PCR جهت تشخیص و تعیین کمی ویروس نقص ایمنی اکتسابی نوع ۱ (HIV-1)

حسن نوربازرگان^۱، علیرضا ناجی^۲، سیامک میراب سمعی^۳، مهدی پریان^۴، سمیرا محمدی یگانه^{۵*}

- ۱- گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۲- آزمایشگاه ویروس شناسی، مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی یمارستان مسیح دانشوری، تهران، ایران
- ۳- آزمایشگاه غذا و دارو مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران
- ۴- مرکز تولیدی و تحقیقاتی انسنتیو پاستور کرج، تهران، ایران
- ۵- مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۶- گروه بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۸/۳

چکیده:

سابقه و هدف: ویروس نقص ایمنی انسانی نوع ۱ (HIV-1) یکی از مهمترین عوامل عفونی منتقل شده از طریق خون است که یک معضل جهانی محسوب می‌شود، بنابراین تشخیص صحیح، دقیق و حساس این ویروس از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه، طراحی یک روش حساس برای تشخیص HIV-1 باشد.

مواد و روش‌ها: آغازگرها و بروب توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیکی برای یک ناحیه ۱۹۹ RNA های حاصل از دنونیسی در آزمایشگاه تهیه شد. همچنین برای بررسی اختصاصی آنالیتیکی از پایگاه Blast و اختصاصیت کلینیکی با استفاده از پانل های ویروسی مختلف و نمونه ژنوم حاصل از افراد سالم استفاده شد.

یافته‌ها: این روش قادر به اندازه گیری حداقل ۱۰ کپی از HIV-1 RNA در هر میلی لیتر است. علاوه بر این، آزمایش در محدوده 10^9 -۱۰ کپی در میلی لیتر خطی است. با بررسی نمونه های منفی، ویژگی این روش 10^9 درصد می باشد. نتایج تکرار پذیری واکنش در سطح درون سنجی و بین سنجی بررسی شد برای این منظور ۹ تکرار از هر غلظت از نمونه کنترل در هر واکنش کاری مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه گیری: با توجه به سطح حساسیت و ویژگی مناسب، آنالیز سریع، کاربرد آسان و هزینه نسبتاً کم در مقابل کیت های مشابه، این روش می‌تواند برای تشخیص موثر ویروس HIV-1 مناسب باشد. همچنین می توان آنلودگی به ویروس را قبل از تغییرات سرمی و ظهور آنتی بادی ها در خون تشخیص داد و دوره پنجه رو غفت را کوتاه تر کرد.

وازگان کلیدی: ویروس نقص ایمنی انسانی نوع ۱، TaqMan Real-time PCR، ژن INT، بار ویروس.

مقدمه

ویروس نقص ایمنی اکتسابی تیپ یک (HIV-1) عامل ایجاد کننده سندرم نقص ایمنی اکتسابی انسانی (ایdz) می باشد انتقال بیماری از طریق انتقال خون در دوره پنجه، در مراکز انتقال خون یک معضل جهانی محسوب می شود. طبق آمار موجود در سراسر جهان بطور متوسط روزانه ۱۳۵۰۰ نفر بر تعداد مبتلایان بیماری ایدز افروزه دارند. لذا با توجه به اهمیت بیماری و گسترش روزافزون آن نیاز به روش های تشخیص عفونت کمک کننده باشد. از جمله مهمترین محدودیت های این روش ها،

نویسنده مسئول: سمیرا محمدی یگانه

پست الکترونیک: s.mohammadiyeganeh@sbmu.ac.ir

استخراج RNA ویروسی

استخراج RNA وپرسی با استفاده از کیت استخراج RNA وپرسی QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen,Germany) صورت گرفت. پس از آن بالافصله واکنش نسخه برداری معکوس با استفاده از کیت Revert AidTM First Strand cDNA Synthesis Kit(Fermentas, USA) بر اساس پروتکل شرکت سازنده انجام گرفت. ابتدا ۱۰ میکرولیتر RNA وپرسی به همراه ۲ میکرولیتر آغازگر رندوم هگزامر، ۴ میکرولیتر بافر آنزیم RT، ۲ میکرولیتر مخلوط (۱۰ میلی مولار) dNTP، ۱ میکرولیتر آنزیم مهارکننده RNase (۲۰ واحد)، ۱ میکرولیتر آنزیم M-MuLV RT (۲۰۰ واحد) در حجم نهایی ۲۰ میکرولیتر اضافه شد. سپس مخلوط واکنش در دستگاه ترموسایکلر متصل گردید و به مدت ۵ دقیقه در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد، یک ساعت در دمای ۴۲ درجه سانتی گراد قرار گرفت و برای غیرفعال کردن واکشن، ۵ دقیقه در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد. cDNA سنتز شده به عنوان: **الگو برای**، موله بعد مورد استفاده قرار گرفت (۱۴).

کلون، که دن قطعه مو، د نظره در بالاسمد

برای سنجش کمی RNA باید از مولکول RNA بعنوان استاندارد استفاده کرد. HIV-1 RNA استاندارد که بصورت پانل های تجاری موجود هستند، هزینه بسیار بالای دارند. از طرف دیگر این پانل ها به راحتی در دسترس محققین قرار نمی گیرند. بنابراین به منظور سنجش کمی مقادیر اسیدنوکلئیک RNA، HIV-1، به استاندارد در آزمایشگاه بصورت (In-house) ساخته شد. این استاندارد با کلون کردن محصول PCR به داخل یک ناقل کلونینگ (cloning vector) حاوی پروموتور آنزیم T7 RNA polymerase به داخل T7 RNA polymerase شد. برای این منظور از کیت (Fermentas, USA) استفاده شد که تهیه شد. وکتور مورد استفاده در این کیت pTZ57R/T حاوی پرموتور برای آنزیم T7 RNA Polymerase است. ابتدا محصول PCR که حاوی یک آویخته (over hang) آدنین (A) پلیمراز می باشد. ابتدا محتوا در آنتهای رشته پلیمریزه شده می باشد، با استفاده از دستورالعمل کیت ACCU Prep در آنهازی PCR خالص شده می باشد، سپس واکنش اتصال (Ligation) میان محصول PCR خالص شده ژن INT و وکتور pTZ57R/T مطابق دستورالعمل کیت انجام گرفت. محصول واکنش اتصال به سویه DH5α باکتری اشرشیاکلی که از قبیل بوسیله CaCl₂ مستعد شده بود انتقال داده (Transform) شد. پس از کشت در محیط LB آگار حاوی آمپی سیلین (100 میکروگرم بر میلی لیتر) کلون های نوترکیب از نظر پلاسمید واحد ژن مورد نظر با استفاده از واکنش colony PCR با آغازر یونیورسال M13 و واکنش هضم آنزیمی تایید شدند (۱۵، ۱۶).

تولید HIV-1 RNA استاندارد

T7 RNA polymerase (Fermentas, USA) استاندارد با استفاده از آنزیم PCR حاصل از آغازگر M13 استفاده شد. این واکنش شامل ۱ میکروگرم T7 RNA polymerase، ۲۰۰ میلی مولار از مخلوط NTP، ۳۰ واحد آنزیم PCR، ۲۰ میکرولت بود.

زدودن RNA از DNA تولید شده در فرایند رونویسی درآزمایشگاه (In-vitro transcription)

از آنجایی که DNA مورد استفاده بعنوان الگو دارای بخش پرموتوئی می باشد، اگر مخصوصاً RNA به دست آمده مستقیماً وارد واکنش Real-time شود، جواب مشت کاذب خواهیم داشت. از این رو باید مخصوصاً بخوبی DNA زدایی شوند. برای این منظور از آنزیم (Fermentas, USA) DNaseI عاری از RNase برای حذف الودگی DNA استفاده شد. از آنجایی که آنزیم I DNase قادر است DNA دو رو شته ای که در هین فرایند PCR تولید می شود را نیز تخریب کند، بنابراین باید بسیار دقتش شود که این آنزیم به طور کامل از محيط حذف شود تا به cDNA هایی که بعنوان مولکول حداست در فرایند PCR عمل می کنند، آسیبی نرساند. برای تخریب و غیرفعال کردن آنزیم I، DNase، مخصوصاً واکنش بمدت ۱۵ دققه در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. از سوی دیگر با قیمانده قطعات و نوکلوتید های حاصل از تخریب با آنزیم I و DNase I با قیمانده خود آنزیم و بافرهای موجود در آن باید حذف شود تا در مراحل بعدی تداخلی ایجاد نکند. برای این منظور از محلول- RNX™ Plus شرکت سینتاژ طبق پروتکل شرکت سازنده RNA سنتر شده خالص شد. در انتهای مقدار اندازی از

عدم تشخیص موارد عفونی در دوره پنجره (Window Period) و زمانی است که هنوز شاخص‌های ایمنی شناختی بیمار بالا نرفته است (۳، ۴). همچنین روش‌های سروولوژی قادر به تشخیص عفونت در نوزادان تازه متولد شده از مادران HIV بدلیل وجود آنتی بادی مادری در این نوزادان نیستند. از علل دیگر که تست‌های سروولوژیکی کفايت لازم را ندارند می‌توان به تعییرات آنتی ژنیک و پریوسی، الودگی با سروتیپ‌های مختلف و پریوسی، ناقلان خاموش از نظر ایمونولوژیکی یا ناقلين پنهان، و یا نبود آنتی بادی در مراحل اولیه بیماری اشاره کرد. لته گزارش‌هایی مبنی بر عدم شناسایی آنتی بادی در مراحل انتهاهی بیماری ایدز به دلیل ضعف شدید سیستم ایمنی و یا گاماگلوبولینمیا در موارد نادر وجود دارد (۳-۶).

بر طبق دستورالعمل های جدید تعیین تعداد کپی RNA این ویروس، به عنوان شاخصی برای تشخیص عفونت حاد، پیش بینی احتمال انتقال ویروس، پیش بینی میزان پیشرفت بیماری در بیمارانی که به طور مزمن آلوهه هستند و برای ارزیابی تأثیر درمان در افرادی که در حال درمان با داروهای ضدترو ویروسی هستند، (۷-۸) از اهمیت بسزایی برخودار است. یکی از جدیدترین روش‌های سنجش کمی که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است سیستم‌های تشخیص در زمان واقعی یا روش Real-time PCR می‌باشد. این روش امکان کمی کردن PCR مرسوم را به صورت بسیار اختصاصی، حساس و با قابلیت بالا فراهم نموده است و مزایایی چون نشان دادن وضعیت واقعی حین آزمایش و امکان تعیین تعداد ویروس را نیز فراهم می‌کند (۹-۱۲). از سال ۲۰۱۳ تکنولوژی ها و دستگاه های متعددی برای تشخیص ویروس HIV (DNA، RNA p24) و Liat TM analyser، Samba VL و RT CPA HIV-1 Viral Load Assay with Gene-RADAR نظیر وجود دارد (۱۳).

این پژوهش با هدف طراحی روش TaqMan Real-time PCR با استفاده از آغازگرها و پروب اختصاصی برای منطقه ای از زن HIV-1 ویروس که از مناطق حفاظت شده از زنوم ویروس می باشد انجام شده است. تحقیق حاضر بمدت یکسال و در دانشگاه علوم پزشکی شهریه بشتی و با همکاری انستیتوپاستور ایران، بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان دی انجام گرفته است.

مواد و روش ها:

طراحی آغازگر و پروپ اختصاصی


بنمودر طراحی آغازگر و پروب ابتدا توالی مربوط به سه زن حفاظت شده *INT-pol-gag* در ژنتیپ های مختلف از پایگاه های داده ی معتبر نظریه Los Alamos- HIV database tools NCBI Nucleotide و INT-pol-gag با استفاده از نرم افزارهای Databank Tهیه شد. سپس با استفاده از نرم افزارهای INT-pol-gag یک ClustalW و MEGA6 نظیر آنالیزهای همدردیفی صورت گرفت و بینترین زن و ناجیه از این زن ها انتخاب شد. چهت طراحی آغازگر و پروب از نرم افزارهای Beacon Designer و AlleleID استفاده شد. پس از طراحی آغازگر ۷,۵ و ۵,۷ از اخصاصیت آنها با NCBI blast و خصوصیات و پیونگی هر کدام با نرم افزارهای Generunner و Oligo ۷ ارزیابی شد. زن INT-1 از HIV-1 به طول ۲۰۰ جفت باز دارای بیشترین و بینترین مناطق حفاظت شده در ژنوم بود و آغازگر و پروب مورد استفاده در این مطالعه برای این ناجیه طراحی شد. (جدول A).

جدول A: توالی آغازگرها و پروپ مربوط به INT HIV-1

آغازگر رفت	5'TAARARRARAGGGGGGATTG'3
آغازگر برگشت	5'CYGCCCTCACCTTCC'3
پروب اختصاصی	FAM-5'AGNAGYTTDGCTGGTCCYTTCAA'3-BHQ


R: A/G Y: C/T N: A/T/G/C

کلون کردن محصول PCR ژن INT ویروس HIV-1 در وکتور pTZ57 R/T
همانطور که قبلاً اشاره شد، واکنش الحاق محصول PCR حاوی انتهای آدنین با وکتور pTZ57 R/T حاوی انتهای تیمیدین و منتقل کردن آن به باکتری اشتباعاً کل سویی DH5α انجام شد. تایید کلونینگ با استفاده PCR روی کلینی های رشد کرده بر روی محیط حاوی آنتی بیوتیک با آغازگرهای اختصاصی و M13 و برش آنزیمی انجام گرفت (شکل ۱).



شکل ۱: واکنش PCR بر روی ژن کلون شده با آغازگرهای (200bp) INT، ۲: واکنش PCR بر روی ژن کلون شده با آغازگرهای (380bp) M13، ۳: لدر 100bp، ۴: برش قطعه کلون شده با آنزیم HindIII به منظور تایید کلونینگ صحیح (270bp)، ۵: وکتور هضم آنزیمی نشده.

تولید RNA استاندارد بمنظور سنجش کمی HIV-1 RNA
در مطالعه حاضر از محصول حاصل از واکنش In-vitro transcription با استفاده از آنزیم T7 RNA polymerase T7 RNA کلون شده RNA سنتز می کند،
بعنوان استاندارد استفاده شد. پس از تایید سنتز آن از طریق الکتروفوروز بر روی ژل آگارز ۲ درصد بمنظور حذف الگو DNA موجود در واکشن، از I DNase استفاده شد سپس I DNase I غیر فعال شد و بمنظور خالص نمودن RNA سنتز شده با محلول استخراج RNA تخلیص شد (شکل ۲).

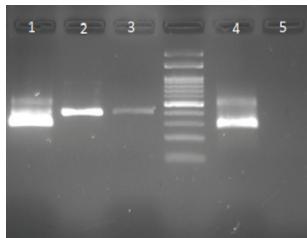

شکل ۲: واکشن PCR با آنزیم in-vitro transcription با آنزیم T7 RNA polymerase حاصل از آغازگرهای M13 که عنوان الگو برای سنتز RNA استفاده شد، ۳: واکشن PCR بدون آنزیم فرماتاز، ۴: RNA تیمار شده با DNase، ۵: واکشن مربوط به چاهک شماره ۳ (DNase I) که حذف شده است.

ارزیابی حساسیت و ویژگی روش
نتایج نشان داد واکشن در محدوده 10^{-10} - 10^{-1} کپی در میلی لیتر خطی است. حساسیت بدست آمده با این روش ۱۰ کپی در هر واکشن می باشد. از آنجایی که هیچ کدام از نمونه های سرم افراد سالم، پاسخ مثبت کاذب ایجاد نکردند، ویژگی این روش در شناسایی HIV-1 درصد محسنه شد. آزمون های تکرار پذیری روی رقت های سریال تهیه شده (10^{-10} - 10^{-1} کپی در میلی لیتر) انجام شد. همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است ضریب تغییرات Ct به دست آمده در آزمون تکرار پذیری درون سنجی و بین سنجش برای تمام رقت های سریال به ترتیب کمتر از ۳ و ۵ درصد بود که نشان میدهد این روش تکرار پذیری بالایی دارد (جدول ۱ و ۲).

در این محدوده کلیه معیارهای Slope، Intercept و R^2 در دامنه تایید شده Real-time PCR اتفاقاً رگرفتند. پارامتر y-intercept برابر $40/59$ می باشد که نشان دهنده

RNA ساخته شده با اسپکتروفوتومتری اندازه گیری و از طریق دانسیته نوری تعداد موکلولهای RNA محاسبه گردید (۱۵).

تعیین حساسیت و ویژگی

حداقل تعداد کپی های ژنوم ویروس موجود در نمونه که می تواند بطور دقیق توسط واکنش Real-time تشخیص داده شود، حساسیت آنالیتیک واکشن می باشد. برای بدست آوردن حساسیت روش، سریال رقت های لگاریتمی از cDNA ساخته شده با ضریب 10^{-10} - 10^{-1} کپی در میلی لیتر تهیه شد. سپس واکشن Real-time بصورت سه بار تکرار برای هر رقت انجام گرفت تا کمترین رقتی که قابل اندازه گیری است مشخص شود.

برای تعیین ویژگی آنالیتیک روش تشخیصی، علاوه بر بررسی صحت اتصال اختصاصی آغازگرهای به الگوی مورد نظر در پایگاه NCBI nucleotide BLAST، از چند نمونه ژنوم ویروس های منتقل شونده از طریق خون از قبیل HCV، HTLV-1، HBV، HHV-8,6، B19، VZV، EBV، HSV-1,2، ویژگی کلینیکی از ۲۰ نمونه منفی، که عدم وجود HIV-1 در آنها با استفاده از روش سروولوژی و مولکولی تجاری معتبر تایید شده بود، استفاده شد. تمامی نمونه های بالینی از مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان سیحی دانشگاه تهران و پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد، تهیه شد. کلیه ای مراحل انجام کار بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق پژوهشکی، وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران و با تصویب کمیته اخلاق دانشکده پژوهشکی دانشگاه علوم پژوهشکی شهید بهشتی (IR.SBMU. MSP.REC.1395.528) انجام شد.

بدست آوردن دقت با استفاده intra-assay و inter-assay

برای این منظور واکشن Real-time بر روی سریال رقت های مختلف تهیه شده (۱۰- 10^{-1}) از cDNA سنتز شده از روی استاندارد تهیه شده بصورت ۳ بار تکرار در هر ران کاری و در ۳ روز متوالی انجام گرفت.

Inter-assay (میان سنجی) به اختلافات موجود در نتایج بین ران های مختلف واکشن Real-time یا نتایج حاصل از آزمایشگاه های مختلف اشاره دارد و معمولاً بصورت SD یا مربوط به تعداد کپی ها یا غلطات های مختلف از هر کدام از رقت های استاندارد ران های کاری در روزهای مختلف بیان می شود. (درون) Intra-assay (یک سیکل Real-time اشاره دارد که بصورت SD برای Cycling Threshold(Ct) مختلف نشان داده می شود. برای این منظور ۳ تکرار از هر غلطات از نمونه کنترل در هر واکشن کاری مورد بررسی قرار میگیرد و مقادیر ضریب تغییرات (CV) برای مقادیر سیکل آستانه (Ct)، ضریب R2 و شب خط برای نمونه های استاندارد محاسبه می شود.

واکشن Real time PCR بمنظور تشخیص HIV-1

برای این منظور از مستر میکس RealQ Plus 2X Master Mix for Probe, High ROX (Amplicon, Denmark) استفاده شد. برای رسم منحنی استاندارد ۹ غلطات مختلف از cDNA تهیه شده با روش In-vitro transcription به میکرو لیتر (۱۰- 10^{-1} کپی در میلی لیتر) انتخاب شد. واکشن تکثیری در حجم ۲۰ میکرو لیتر انجام شد که مشتمل بر ۱۰ میکرو لیتر از مستر میکس، ۵ میکرو لیتر cDNA از رقت های سریالی تهیه شده با نسبت ۱/۱۰، ۲/۵ میکرومولار از هر آغازگر و ۴ میکرومولار از پروب و با الگوی دمائی زیر انجام شد (۱۵).

۵۰ درجه سانتی گراد بمدت ۱ دقیقه، ۹۵ درجه سانتی گراد بمدت ۱۵ دقیقه و سپس ۴۰ درجه شامل: ۹۵ درجه سانتی گراد بمدت ۱۵ ثانیه، ۵۲ درجه سانتی گراد بمدت ۳۰ ثانیه و ۶۰ درجه سانتی گراد بمدت ۳۰ ثانیه. تمامی واکشن ها و آنالیز اطلاعات توسط دستگاه ABI (StepOne plus) انجام شد.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

تمام آزمایش ها حداقل سه بار تکرار شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS ۱۶ به صورت میانگین \pm SD گزارش شده و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه ای نتایج به کار بردند. P value کمتر از ۰,۰۵ به عنوان سطح معناداری در نظر گرفته شد.

یافته ها:

جدول ۱: نتایج آزمون تکرارپذیری درون سنجی

ضریب تغییرات (%)	$\pm SD$	میانگین مقادیر Ct	تعداد کپی HIV-1 RNA در واحد میلی لیتر
۲/۴	+/-۲	۸/۳	10^9
۱	+/-۱۲	۱۲/۴	10^8
۱/۱	+/-۱۷	۱۶	10^7
۰/۶	+/-۱۲	۱۹/۸	10^6
۰/۴	+/-۱	۲۳/۶	10^5
۰/۶	+/-۱۶	۲۷/۴	10^4
۰/۶	+/-۱۸	۳۰/۹	10^3
۰/۳	+/-۰/۹	۳۳/۵	10^2
۲/۵	+/-۸۰	۳۵/۹	۱۰

جدول ۲: نتایج آزمون تکرارپذیری بین سنجی

ضریب تغییرات (%)	$\pm SD$	میانگین مقادیر Ct	تعداد کپی HIV-1 RNA در واحد میلی لیتر
۴/۵	+/-۳۹	۸/۷	10^9
۲/۵	+/-۳۱	۱۲/۳	10^8
۰/۹	+/-۱۵	۱۶	10^7
۴	+/-۷۹	۲۰	10^6
۲/۳	+/-۵۴	۲۳/۷	10^5
۱/۹	+/-۵۳	۲۷/۴	10^4
۱/۲	+/-۳۶	۳۰/۸	10^3
۲/۳	+/-۷۷	۳۳/۷	10^2
۰/۷	+/-۲۶	۳۶/۲	۱۰


حساسیت و دقت مقدار سنجی روش طراحی شده می باشد. Slope برابر با $-3/4$ و ضریب $R^2 = 995/0R^2$ بدست آمد که نشان دهنده کارایی بالای واکنش انجام شده می باشد (شکل ۳).

بحث

پایان دادن به بیماری همه گیر ایدز یکی از هدف های اصلی بهداشت جهانی است که از طریق همبستگی جهانی و مشارکت چندبخشی امکانپذیر خواهد بود. در دسامبر ۲۰۱۳، هیئت هماهنگی برنامه ایدز سازمان ملل (UNAIDS) (B) بنظر هماهنگ کرد تلاش های کشورها و مناطق درگیر با این بیماری، طرحی را تحت عنوان درمان HIV در مقیاس بالا تا سال ۲۰۱۵ مطرح کرد. در حال حاضر هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی، سازمان UNAIDS و سازمانهای مرتبط با HIV این است که تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۷۳٪ از تمام مردمی که با HIV زندگی میکنند، این ویروس در آنها مهار خواهد شد. (۱۶).

در افرادی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده و نوزادان که قادر به تولید آنتی بادی برعلیه ویروس نباشند در این صورت انجام تست های بر پایه سروبوژی با هر کیتی ممکن است پاسخ منفی دهد. لذا در چنین مواردی انجام این تست ها نمی تواند قابل اطمینان باشد. بنابراین، در تفسیر نتایج این گونه نمونه ها دقت بسیار زیادی لازم است (۱۷).

برای کاهش این عوامل، روش های مبتنی بر اسید نوکلئیک NAT(Nucleic Acid

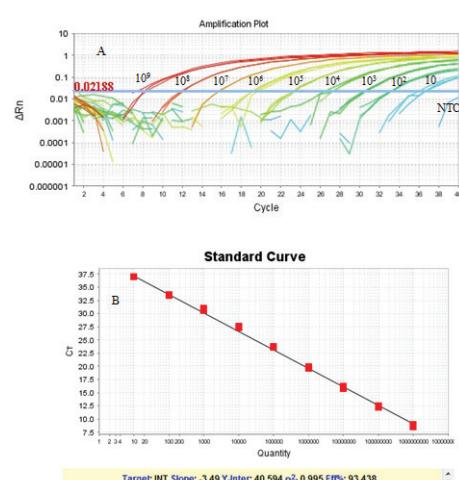

شکل ۳: A: نمودار منحنی تکثیر با رقت های متوالی ۱۰۹-۱۰ کپی در میلی لیتر. B: منحنی استاندارد سنجش کمی HIV-1. این منحنی حاصل لگاریتم رقت های سریال در مقابل Ct مربوط به هر رقت می باشد.

پرور طراحی کردند. این روش حساسیت بالایی با محدوده خطی بین ۴۰ تا ۱۰ میلیون کپی در میلی لیتر را نشان می دهد. همچنین در مطالعه ای دیگر kamangu و همکارانش روشی جهت شناسایی زن LTR با حداقل محدودیت تشخیص در حدود ۱/1095 log کپی در میلی لیتر، نتایج حاصل از این مطالعه در مقایسه با روش‌هایی که برای شناسایی ویروس HIV-1 طراحی شده نشان می دهد که زن INT برای اولین بار عنوان یک هدف جهت شناسایی این ویروس استفاده شده است. همچنین محدوده خطی و حداقل محدودیت تشخیص روش طراحی شده قابل مقایسه با سایر روش‌های ارائه شده می باشد (۲۴, ۲۵).

تاکنون در ایران هیچ روش کمی بر پایه روش TaqMan Real time PCR برای تعیین کمی ویروس HIV-1 طراحی نشده است و مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران انجام گرفته است.

علاوه بر حساسیت و اختصاصیت بالا این روش تشخیصی دارای سهولت کاربرد بوده و در مدت زمان کمتری قادر به تعیین عیار RNA ویروس می باشد و از آن به راحتی می توان در مراکز تشخیصی استفاده کرد. همچنین استانداردهایی که به صورت پنل های تجاری موجود هستند، هزینه بسیار بالایی دارند و از نظر در دسترس قرارگیری آن ها نیز محدودیت های بسیاری گریبانگر محققین است. در حالیکه استانداردهای تهیه شده در این تحقیق در آزمایشگاه بسیار ازان تر بوده و از انجایی که روش حاضر محدوده دینامیکی گستردۀ ای دارد، میتواند در تشخیص مواد حاد بیماری و پیگیری نتایج درمانی در بیماران در حال درمان که بارهای ویروسی متعددی دارند مفید باشد. از آنجایی که تکنیک Real-time PCR بر پایه پرور TaqMan به انجام مراحل بعد از فرایند تکثیر (post amplification) نیاز ندارد، علاوه بر کاهش هزینه ها، انتقال آلودگی های تکنیکی که منجر به پاسخ مثبت کاذب می شود را به حداقل می رساند همچنین این روش در آزمایشگاههایی که توان مالی بالا ندارند جایگزین مناسبی برای روش های تجاری پرهزینه می باشد. در این پژوهش از زن ویژه INT که فوق العاده در بین انواع زنوتیپ های ویروس حفاظت شده است استفاده شده که در روش های دیگر استفاده نشده است، لذا حساسیت و پیگیری روش نسبت به آزمایش های و روش های موجود بسیار افزایش و بهبود یافته است. همچنین مزایای دیگری نظری افزایش سرعت از طریق کاهش زمان تکثیر، حذف مرحله آشکارسازی پس از تکثیر، حساسیت بالا و ساده زنی سریع از مزایای عده این تکنیک می باشد (۲۵).

علاوه بر آسان بودن و آنالیز سریع از مزایای عده این تکنیک می باشد (۲۶). در مطالعه دیگری که برای برسی کارآیی و سودمندی این روش در نمونه های بالینی با لودهای مختلف ویروس HIV-1 توسط تیم تحقیقاتی حاضر انجام شد، نتایج آنالیز پژوهیت نشان داد این روش در نمونه های مختلف بالینی دارای رنج خطی مناسب بوده و با احتمال بیش از ۹۵٪ می تواند حداقل ۱۳ کپی از ویروس در پلاسمما را ردیابی نماید (۲۶). بنابراین با توجه به نتایج دو مطالعه اخیر به نظر می رسد از روش فوق می توان در مراکز تشخیصی به عنوان روش کمکی در تشخیص استفاده نمود و علاوه بر آن می توان دوران پنجه را کوتاه تر کرد. علاوه بر موارد ذکر شده، از این روش می توان در تشخیص آلودگی یا عفونت نوزادان متولد شده از مادران آلوده به HIV نیز استفاده نمود. مجموع این موارد باعث می شود که بیماری در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود تا از گسترش عفونت جلوگیری کند و فرصت راه کارهای درمانی مناسب را فرا روی پزشکان و بیماران قرار دهد (۲۷).

تشکر و قدردانی:

مقاله حاضر، حاصل بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب در معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد ثبت ۱۰۱۷۵ می باشد که عنوان پایان نامه دکتری بیوتکنولوژی آقای حسن نوری‌زارگان انجام شده است. در اینجا لازم است از همکاری مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انسٹیتوپاستور ایران جهت فراهم نمودن شرایط انجام طرح قدرانی و تشکر نماییم.

Testing برای شناسایی اسید نوکلئیک ویروسها توسعه یافته اند. از مزایای NAT می توان به بررسی مستقیم و اختصاصیت بسیار زیاد آن برای ژنوم یک عامل عفونی نسبت به روش‌های سروولوژیک یا روش‌های جداسازی ویروسی (به منظور شناسایی آن) اشاره کرد. آزمایش تعیین میزان HIV-1 RNA در تشخیص عفونت حاد، پیش آگهی سیر بیماری، کمک به محاسبه میزان خطر افزایش انتقال در بیمارانی که به طور مژمن آلوده هستند و مهمتر از همه برای مانیتورینگ درمان در افراد آلوده و بیمارانی که داروهای ضد رتروویروسی استفاده شده اند. عیار ویروس با میزان کاهش سلول های CD4+ ارتباط دارد و یک اندیکاتور مهم در پیش آگهی بیماری در مراحل اولیه عفونت به شمار می رود (۵, ۷, ۹).

در حال حاضر روش های مختلفی برای سنجش کمی HIV-1 RNA در نمونه های بالینی توسعه یافته است. از جمله HIV-1 RNA در نمونه های NASBA و RT-PCR، bDNA (branched DNA) (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) صورت تجاری در دسترس قرار گرفته اند. متأسفانه این کیت های تجاری هزینه بسیار بالایی دارند که خرید آن ها در توان مالی بسیاری از آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز تحقیقاتی نیست. علاوه بر این، در دسترس نبودن همیشگی آن ها نیز محدودیت های زیادی ایجاد می کند (۱۹, ۲۰).

بنظور کنترل و آگاهی از وضعیت درمان بیماران، مهم است که روشی که برای سنجش کمی بار ویروس استفاده می شود نتایج دقیق و تکرار پذیر داشته باشد. در این پژوهش، تکرارپذیری در سطح درون سنجی (Intra assay) و بین سنجی (Inter assay) بررسی شد. تکرارپذیری درون سنجی، خطای کاربر و نیز خطای کالیبره نبودن ابزارهای مورد را بررسی می کند. این در صورتی است که تکرارپذیری بین سنجش، خطای آزمایشگاه اعم از دستگاه ها، آنزیم یا مستریمیکس مورد استفاده و کالیبره نبودن استانداردها، مواد، ماندگاری و پایداری واکنش را بررسی می کند. بر اساس معیارها و دستورالعمل های معروف شده از سوی CAP (College of American Pathology) ضریب تغییرات برای تکرارپذیری درون سنجش نباید بیشتر از ۵ درصد بوده و نیز برای تکرارپذیری بین سنجش کمتر از ۱۰ درصد، نشان دهنده تکرارپذیر بودن مناسب یک آزمایش است که در روش ما بترتیب کمتر از ۳ و ۵ بوده است (۱۵).

روش راه اندازی شده در این پژوهش می تواند به عنوان راهنمای مفیدی در تشخیص اولیه عفونت HIV در کودکان و نیز آگاهی از وضعیت کفایت و تأثیر درمان ترکیبی بیماران آلوده باشد . در بسیاری از کشورها با استطاعت مالی محدود، به منظور تجویز دارو و پیگیری درمان، از اندازه گیری بار ویروسی HIV به خاطر هزینه بالا چشم پوشی می شود. راه اندازی این روش که هزینه کمی نیز دارد، می تواند حداقل به خاطر مانع از ظهور ویروس های مقاوم به درمان بخشی از آگاهی از وضعیت درمان را بر عهده بگیرد.

یک روش In-house Real Time PCR assay جهت شناسایی ساب تیپ C ویروس HIV توسط Acharya و همکارانش بر اساس نواحی حفاظت شده زن gag و طراحی شد. خطی بودن این روش در محدوده ۵۰ کپی از ژنوم ویروس تا ۱۰^۷ کپی از ویروس به ازای هر ml از نمونه پلاسما می باشد و کمترین محدوده تشخیصی آن در حدود ۵۰ copies/ml از ژنوم ویروس می باشد (۲۱). در مطالعه ای دیگر در هند یک روش HIV-1 TaqMan real time PCR assay جهت شناسایی ساب تیپ C ویروس HIV بر پایه زن gag و CSF بر روی نمونه های پلاسما و CSF برای سنجش میزان RNA ویروس طراحی شد. این روش قادر به شناسایی تمامی ساب تیپ های M ویروس HIV-1 به جز ساب تیپ E بوده است. حساسیت این روش در حدود ۱۸۰ copies/ml و بوده و ارتباط این روش با روش های تجاری موجود در حدود ۱۸۵ بوده است و حتی از روش Amplicor monitor assay, Version 1.5 (400 copies/ml) بیشتر بوده است (۲۲).

و همکارانش یک روش کمی برای شناسایی زن pol ویروس HIV بر پایه Tang

منابع:

1. Maartens G, Celum C, Lewin SR. HIV infection: epidemiology, pathogenesis, treatment, and prevention. *Lancet.* 2014;384(9939):258-71.
2. Simon V, Ho DD, Abdoor Karim Q. HIV/AIDS epidemiology, pathogenesis, prevention, and treatment. *Lancet.* 2006;368(9534):489-504.
3. Lane TA, Gernsheimer TB, Busch MP, Holland P. Transfusion of the HIV-seropositive patient. *Transfus Med Rev.* 1999;13(4):334.
4. Siliciano JD, Kajdas J, Finzi D, Quinn TC, Chadwick K, Margolick JB, et al. Long-term follow-up studies confirm the stability of the latent reservoir for HIV-1 in resting CD4+ T cells. *Nat Med.* 2003;9(6):727-8.
5. Detrick B, Hamilton RG, Folds JD. Manual of Molecular and Clinical Lab Immunology: American Society for Microbiology Press; 2006.
6. Gupta V, Gupta S. Laboratory markers associated with progression of HIV infection. *Indian journal of medical microbiology.* 2004;22(1):7.
7. Gilks CF, Crowley S, Ekpini R, Gove S, Perriens J, Souteyrand Y, et al. The WHO public-health approach to antiretroviral treatment against HIV in resource-limited settings. *Lancet.* 2006;368(9534):505-10.
8. Jahanbakhsh F, Mostafavi E, Haghdoost A. The potential for HIV self-testing in Iran. *International journal of preventive medicine.* 2015;6.
9. Williams I, Churchill D, Anderson J, Boffito M, Bower M, Cairns G, et al. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2012. *HIV medicine.* 2012;13(S2):1-6.
10. Schmitt Y. Performance characteristics of quantification assays for human immunodeficiency virus type 1 RNA. *Journal of clinical virology.* 2001;20(1):31-3.
11. Wong ML, Medrano JF. Real-time PCR for mRNA quantitation. *Biotechniques.* 2005;39(1):75.
12. Mellors JW, Kingsley LA, Rinaldo CR, Todd JA, Hoo BS, Kokka RP, et al. Quantitation of HIV-1 RNA in plasma predicts outcome after seroconversion. *Annals of internal medicine.* 1995;122(8):573-9.
13. Branson BM, Owen SM, Wesolowski LG, Bennett B, Werner BG, Wroblewski KE, et al. Laboratory testing for the diagnosis of HIV infection: updated recommendations. 2014.
14. Handbook.pdf>, Q.G.Q.V.R.M.H.h.w.E.-Q.V.R.M.
15. Bustin SA, Benes V, Garson JA, Hellemans J, Huggett J, Kubista M, et al. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. *Clinical chemistry.* 2009;55(4):611-22.
16. 90-90-90An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic. UNAIDS / JC2684 (English original, October 2014).
17. Shetty S, Prabhu S, Hallikeri K, Krishnapillai R. Laboratory Tests for HIV: Diagnosing, monitoring and managing AIDS-an overview. *International Journal of Oral and Maxillofacial Pathology.* 2011;2(1):20-8.
18. Yilmaz G. Diagnosis of HIV infection and laboratory monitoring of its therapy. *Journal of clinical virology.* 2001;21(3):187-96.
19. Ernest I, Alexandre I, Zammattéo N, Herman M, Houbion A, De Leener F, et al. Quantitative assay for group M (subtype A-H) and group O HIV-1 RNA detection in plasma. *J Virol Methods.* 2001;93(1):1-14.
20. Katsoulidou A, Papachristou E, Petrodaskalaki M, Sypsa V, Anastassopoulou CG, Gargalianos P, et al. Comparison of three current viral load assays for the quantitation of human immunodeficiency virus type 1 RNA in plasma. *J Virol Methods.* 2004;121(1):93-9.
22. Acharya A, Vaniawala S, Shah P, Parekh H, Misra RN, Wani M, et al. A robust HIV-1 viral load detection assay optimized for Indian sub type C specific strains and resource limiting setting. *Biological research.* 2014;47(1):22.
23. Kamat A, Ravi V, Desai A, Satishchandra P, Satish K, Borodowsky I, et al. Quantitation of HIV-1 RNA levels in plasma and CSF of asymptomatic HIV-1 infected patients from South India using a TaqMan real time PCR assay. *Journal of clinical virology.* 2007;39(1):9-15.
24. KAMANGU E, Chatte A, Boreux R, Susin F, KALALA R, Mwumbi GL, et al. Comparison of an In-House Quantitative Real-Time PCR and COBAS ampliprep/Taqman Roche for determination of viral load for HIV type 1 non-b. *Open Access Library Journal.* 2015;2(e1402).
25. Tatarelli P, Taramasso L, Di Biagio A, Sticchi L, Nigro N, Barresi R, et al. HIV-1 RNA quantification in CRF02_AG HIV-1 infection: too easy to make mistakes. *New Microbiol.* 2016;39:150-2.
26. Noorbazargan H, Nadji SA, Samiee SM, Paryan M, Mohammadi-Yeganeh S. New design, development, and optimization of an in-house quantitative TaqMan Real-time PCR assay for HIV-1 viral load measurement. *HIV clinical trials.* 2018;19(2):61-8.
27. Gibellini D, Vitone F, Gori E, La Placa M, Re MC. Quantitative detection of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) viral load by SYBR green real-time RT-PCR technique in HIV-1 seropositive patients. *J Virol Methods.* 2004;115(2):183-9.